




POLARIMETER | MESSRÖHREN

PASSENDE MESSRÖHREN FÜR DIE KOMFORTABLE PROBENZUFUHR

Version 2.3 Februar 2024

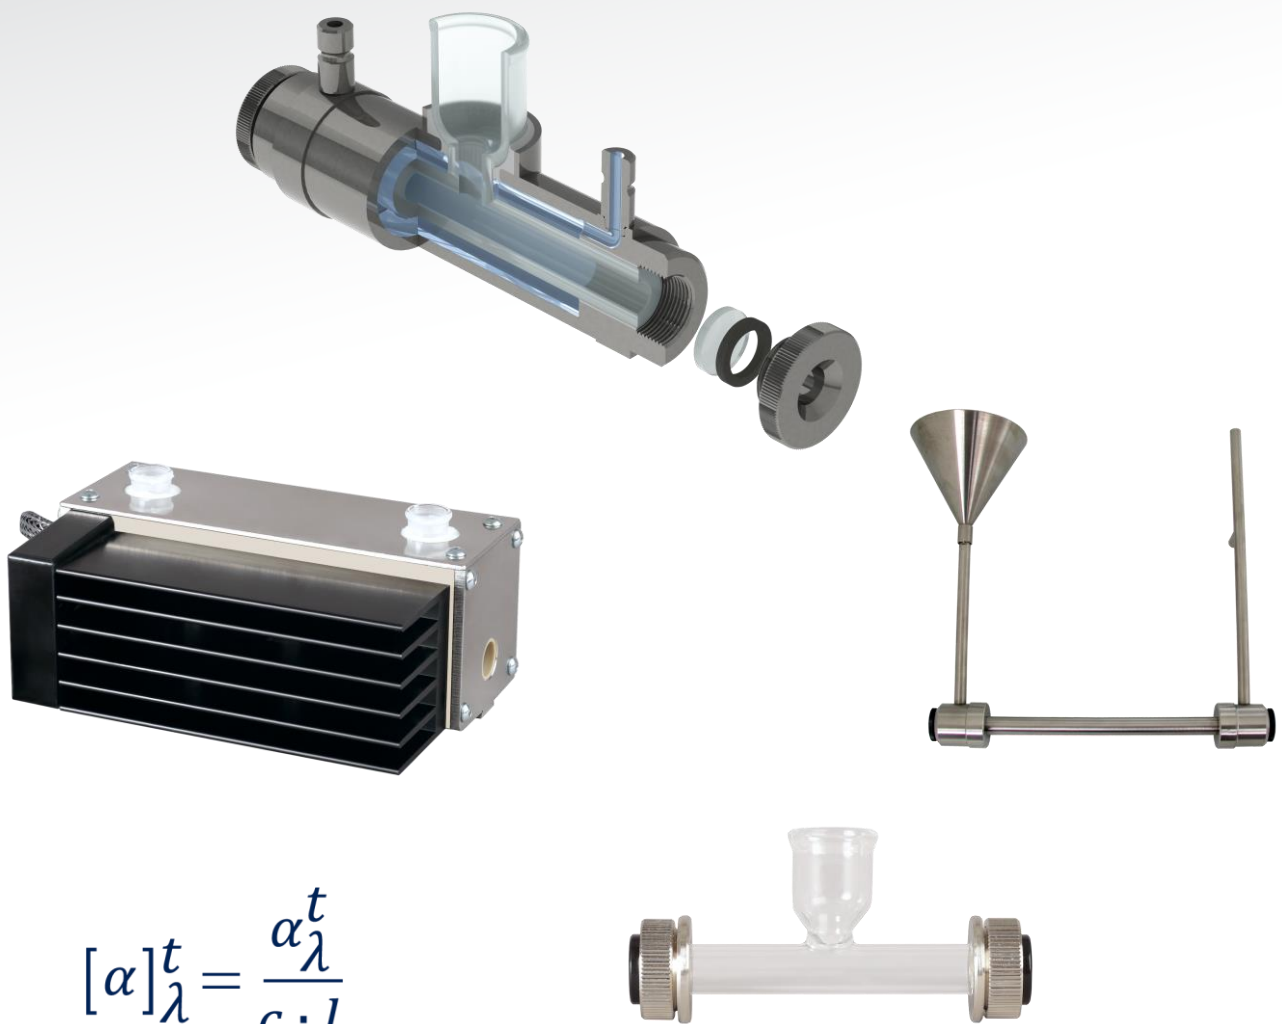

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha_{\lambda}^t}{c \cdot l}$$

INHALT

MIKRO-MESSRÖHREN – NICHT TEMPERIERBAR	4
DURCHFLUSS-MESSRÖHREN – NICHT TEMPERIERBAR	5
MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (UMWÄLTHERMOSTAT PT80/PT31).....	6
POLARIMETER-MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (UMWÄLTHERMOSTAT PT80/PT31)	7
POLARIMETER MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (PELTIER-TEMPERIERUNG)	8
POLARIMETER QUARZ-KONTROLLPLATTEN.....	9

POLARIMETER ÜBERSICHT



Polarimeter P8000 und P8100

Empfehlenswerte Geräte für alle Basisanwendungen ohne Proben temperierung. Anstelle einer Temperierung kann dort die Temperaturkompensation nach ICUMSA genutzt werden.

[\(A.KRÜSS-Website\)](#)



Polarimeter P8000-P und P8100-P

Hochpräzise Messungen durch Proben temperierung ohne externes Zusatzgerät und exakte Temperierung mittels Peltier-Technologie.

[\(A.KRÜSS-Website\)](#)



Polarimeter P8000-T und P8100-T

Diese Polarimeter-Modelle ermöglichen in Verbindung mit temperierbaren Messröhren und einem Umwälzthermostaten (PT31/PT80) eine Proben temperierung zwischen 8 °C bis 40 °C bei PT31 und 5 °C bis 80 °C bei PT80.

[\(A.KRÜSS-Website\)](#)



Polarimeter P3000

Gerät zugeschnitten für Standardanwendungen, als ökonomische Lösung für Messungen bei denen eine Messgenauigkeit von $\pm 0,01^\circ$ ausreicht und eine Temperierung entfallen kann.

[\(A.KRÜSS-Website\)](#)



Polarimeter P1000-LED

Gerät für Lehre und Ausbildung, das die optische Rotation nach dem Halbschattenprinzip misst. Die Messergebnisse werden über ein Okular und zwei Nonien abgelesen.

[\(A.KRÜSS-Website\)](#)



GLAS-MESSRÖHREN – NICHT TEMPERIERBAR

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER						
MESSRÖHRE	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	P3000 Ohne Temperierung ²⁾	P1000- LED Ohne Temperierung	
Glas-Messröhre (nicht temperierbar) PRG-50-E und PRG-100-E und PRG-200-E						
 Verfügbare Röhrenlängen: 50/100/200 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Nein Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 3ml/50 mm 6 ml/100 mm 12 ml/200 mm	Kürzel-Name: PRG/ P/ Polarimeter R/ Röhre G/ Glas E/ Einfülltrichter	PRG-100-E und PRG-200-E sind im Lieferumfang enthalten.	PRG-100-E und PRG-200-E sind im Lieferumfang enthalten.	PRG-100-E und PRG-200-E sind im Lieferumfang enthalten.		
Glas-Messröhre (nicht temperierbar) PRG-100 und PRG-200						
 Verfügbare Röhrenlängen: 100/200 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Nein Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 12 ml/100 mm 22 ml/200 mm	Kürzel-Name: PRG/ P/ Polarimeter R/ Röhre G/ Glas	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar im Lieferumfang enthalten

¹⁾Angabe zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.

²⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

MESSRÖHREN – NICHT TEMPERIERBAR

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER						
MESSRÖHRE	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	P3000 Ohne Temperierung ³⁾	P1000- LED Ohne Temperierung	
Mikro-Glas-Messröhre (nicht temperierbar) PRG-50-M und PRG-100-M						
 Verfügbare Röhrenlängen: 50/100 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Nein Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 0,55 ml/50 mm 1,1 ml/100 mm	Kürzel-Name: PRG/ P/ Polarimeter R/ Röhre G/ Glas	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar
Durchfluss-Edelstahl-Messröhre (nicht temperierbar) PRM-100-D und PRM-200-D						
 Verfügbare Röhrenlängen: 100/200 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Ja Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 12 ml/100 mm 17 ml/200 mm	Kürzel-Name: PRM/ P/ Polarimeter R/ Röhre M/ Metall D/ Durchfluss (mit Einfülltrichter)	Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar	Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar	Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar	Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar	



¹⁾Angabe zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.

²⁾P8020 = Probenkammer-Durchführung

Wird benötigt, um die Probenbefüllung per Pumpe zu organisieren oder die Temperierung zu ermöglichen (Durchführung der Schläuche)

³⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

DURCHFLUSS-MESSRÖHREN – NICHT TEMPERIERBAR

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER						
MESSRÖHRE	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	P3000 Ohne Temperierung ³⁾	P1000 -LED Ohne Temperierung	
Glas-Messröhre (temperierbar) PRG-100-ET und PRG-200-ET						
 Verfügbare Röhrenlängen: 100/200 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Nein Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 4 ml/100 mm 8 ml/200 mm	Kürzel-Name: PRG/ P/ Polarimeter R/ Röhre G/ Glas E/ Einfülltrichter T/ temperierbar (über Wassermantel)			Empfohlene Glas-Messröhre		
Edelstahl-Messröhre mit Einfülltrichter (temperierbar) PRM-100-ET und PRM-200-ET						
 Verfügbare Röhrenlängen: 100 mm / 200 mm Luer Anschluss: Nein Durchfluss: Nein Benötigtes Probenvolumen ¹⁾ : 12 ml/100 mm 17 ml/200 mm	Kürzel-Name: PRM/ P/ Polarimeter R/ Röhre M/ Metall E/ Einfülltrichter T/ temperierbar (über Wassermantel)			Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar		



¹⁾Angabe zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.

²⁾P8020 = Probenkammer-Durchführung

Wird benötigt, um die Probenbefüllung per Pumpe zu organisieren oder die Temperierung zu ermöglichen (Durchführung der Schläuche)

³⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (UMWÄLTHERMOSTAT PT80/PT31)

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER					
MESSRÖHRE	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	P3000 Ohne Temperierung ³⁾	P1000- LED Ohne Temperierung
Durchfluss-Edelstahl-Messröhre (temperierbar) PRM-100-DTT und PRM-200-DTT					
 <p>Verfügbare Röhrenlängen: 100/200 mm</p> <p>Luer Anschluss: Nein</p> <p>Durchfluss: Ja</p> <p>Benötigtes Probenvolumen¹⁾: 12 ml/100 mm 17 ml/200 mm</p>	<p>Kürzel-Name: PRM/ P/Polarimeter R/Röhre M/Metall</p> <p>D/Durchfluss (mit Einfülltrichter) T/temperierbar (über Wassermantel) T/Temperaturfühler</p>			Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar	
Temperaturfühler PRT-E und PRT-T					
				Verwendbar mit allen Messröhren, die über einen Einfülltrichter verfügen. ⁴⁾	
PRT-E Temperaturfühler Edelstahl					
PRT-T Temperaturfühler Edelstahl, PTFE-beschichtet					

¹⁾Angabe zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.



²⁾ **P8020 = Probenkammer-Durchführung**

Wird benötigt um die Probenbefüllung per Pumpe zu organisieren (Durchführung der Schläuche) oder die Temperierung zu ermöglichen (Durchführung Temperierschläuche)

³⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

⁴⁾ Ist kein Einfülltrichter vorhanden, liegt der Temperaturfühler direkt in der Probenkammer.

POLARIMETER-MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (UMWÄLTHERMOSTAT PT80/PT31)

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER						
MESSRÖHRE	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	P3000 Ohne Temperierung ³⁾	P1000- LED Ohne Temperierung	
Durchfluss-Edelstahl-Messröhre (temperierbar) PRM-100-DT und PRM-200-DT						
 <p>Verfügbare Röhrenlängen: 100 / 200 mm</p> <p>Luer Anschluss: Nein</p> <p>Durchfluss: Ja</p> <p>Benötigtes Probenvolumen¹⁾: 12 ml/100 mm 17 ml/200 mm</p>	<p>Kürzel-Name: PRM/ P/Polarimeter R/Röhre M/Metall</p> <p>D/Durchfluss (mit Einfülltrichter)</p> <p>T/temperierbar (über Wassermantel)</p>			Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar		
Durchfluss-Edelstahl-Messröhre (temperierbar) PRM-200-SDT						
 <p>Verfügbare Röhrenlängen: 200 mm</p> <p>Luer Anschluss: Nein</p> <p>Durchfluss: Ja</p> <p>Benötigtes Probenvolumen¹⁾: 17 ml/200 mm</p>	<p>Kürzel-Name: PRM/ P/Polarimeter R/Röhre M/Metall</p> <p>S/Schlauchanschluss D/Durchfluss T/temperierbar (über Wassermantel)</p>			Nur zusammen mit P8020 ²⁾ verwendbar		


¹⁾Angabe zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.

²⁾ P8020 = Probenkammer-Durchführung

Wird benötigt, um die Probenbefüllung per Pumpe zu organisieren (Durchführung der Schläuche) oder die Temperierung zu ermöglichen (Durchführung Temperierschläuche)

³⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

POLARIMETER MESSRÖHREN – TEMPERIERBAR (PELTIER-TEMPERIERUNG)

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER						
MESSRÖHRE	P8000 P8100	P8000-P P8100-P	P8000-T P8100-T	P3000	P1000- LED	
	Ohne Temperierung	Temperierung mit Peltier- Technologie	Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren empfohlen	Ohne Temperierung ²⁾	Ohne Temperierung	
Glas-Messröhre (Peltier-Temperierung)						
PRG-100-EPT						
 <p>Verfügbare Röhrenlängen: 100 mm</p> <p>Luer Anschluss: Nein</p> <p>Durchfluss: Nein</p> <p>Benötigtes Probenvolumen¹⁾: 8 ml/100 mm</p>	<p>Kürzel -Name: PRG/ P/Polarimeter R/Röhre G/Glas</p> <p>EPT/Peltier- Temperierung (mit zwei Befüllöffnungen)</p>	Nicht nutzbar	Empfohlene Glas- Messröhre	Nicht nutzbar	Nicht nutzbar	Nicht nutzbar

¹⁾Angaben zum Probenvolumen sind „ca. Angaben“ und berücksichtigen nicht die Füllhöhe des Einfülltrichters bzw. die jeweiligen Produkttoleranzen.

²⁾Temperierung auf Anfrage möglich.

POLARIMETER QUARZ-KONTROLLPLATTEN

EINSETZBAR FÜR POLARIMETER					
Quarz-Kontrollplatten 	P8000 P8100 Ohne Temperierung	P8000-P P8100-P Temperierung mit Peltier- Technologie	P8000-T P8100-T Temperierung Umwälzthermostat/ temperierbare Messröhren	P3000 Ohne Temperierung ¹⁾	P1000- LED Ohne Temperierung
Polarimeter Quarz-Kontrollplatte PQP-Modelle					
PQP+17 Drehwinkel: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z)	Premium Quarz-Kontrollplatte für die gesamte Gerätefamilie geeignet, Genauigkeit: ±0,001°, Mit Werkzertifikat rückführbar auf PTB, PTB zertifizierbar (PTB-Zertifikat auf Anfrage mit Zusatzkosten), Wellenlänge: 589 nm, Temperatur: 20 °C, Gehäuse: Edelstahl				
PQP+34 Drehwinkel: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z)					
PQP-17 Drehwinkel: -17° (±1°), -50 °Z (±1 °Z)					
Polarimeter Quarz-Kontrollplatte PQE-Modelle					
PQE+17 Drehwinkel: +17° (±1°), +50 °Z (±1 °Z)	Standard Quarz-Kontrollplatte für die gesamte Gerätefamilie geeignet, Genauigkeit: ±0,005°, Mit Werkzertifikat rückführbar auf PTB, Nicht PTB zertifizierbar, Wellenlänge: 589 nm, Temperatur: 20 °C, Gehäuse: Edelstahl				
PQE+34 Drehwinkel: +34° (±1°), +99 °Z (±1 °Z)					
PQE-17 Drehwinkel: -17° (±1°), -50 °Z (±1 °Z)					
PQE-34 Drehwinkel: -34° (±1°), -99 °Z (±1 °Z)					

¹⁾Temperierung auf Anfrage möglich.



Für mehr Informationen scannen Sie einfach den QR-Code.



ENTDECKEN SIE DIE WELT DER A.KRÜSS-MESSGERÄTE AUF UNSERER WEBSITE

Hier können Sie unsere große Auswahl an hochwertigen Geräten kennenlernen.

LERNEN SIE VON DEN EXPERTEN!

Zu jeder Untersuchungsmethode und jedem Gerät bieten wir umfangreiche Fachinformationen: Sie können Praxistipps zur Reinigung erfahren, Fachinformationen zur Probenmessung sowie zu Normen und Richtlinien erhalten oder Sie sehen unsere Geräte als Videodemonstration im Praxiseinsatz.

GERÄTE DIREKT SEHEN UND ENDECKEN. WIR SIND NUR EINEN KLICK ENTFERNT!

Für Sie demonstrieren wir unsere Produkte vor Ort oder via Videokonferenz direkt aus unserem Labor in Hamburg. So können Sie unsere Messgeräte Online live erleben und mit unseren Experten sprechen.